

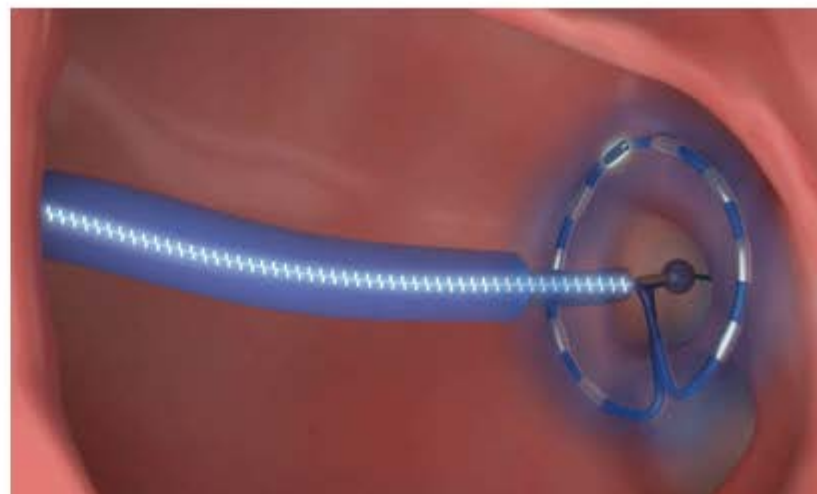


図1 : PulseSelect PFA Loopカテーテル (Medtronicより)

図2 : パルスエネルギー送付時のイメージ (Medtronicより)

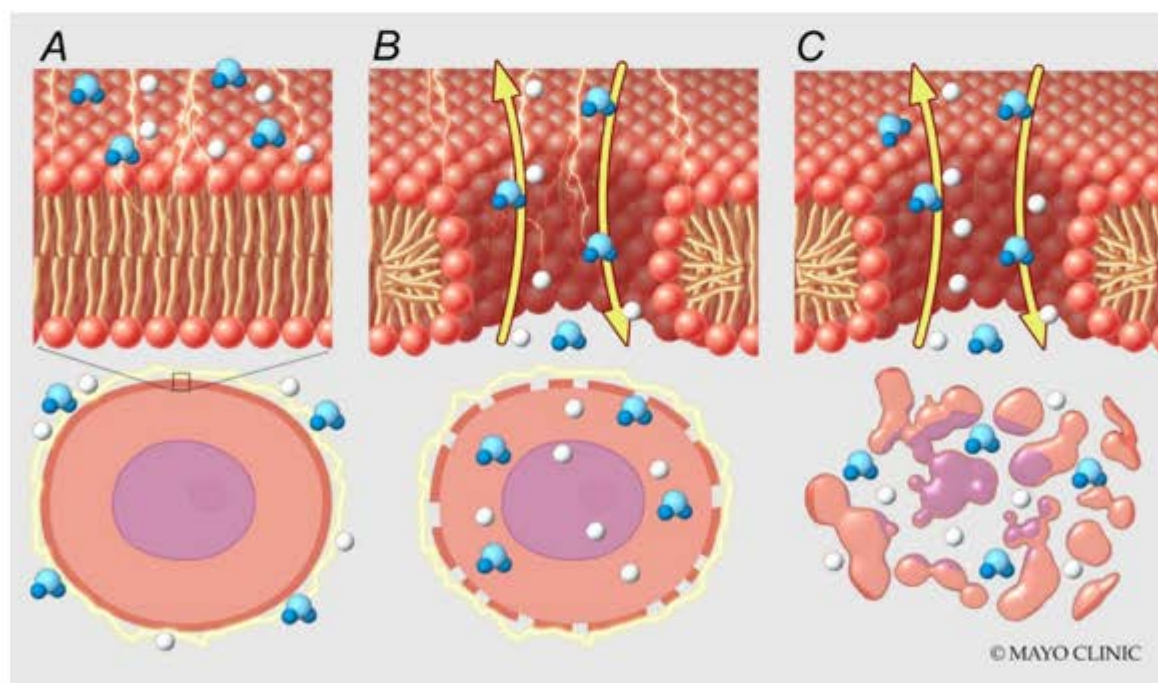


図3 : 高電圧をかけることで細胞の膜を破壊し、アポトーシスを誘導している様子

Ezzeddine FM. J Clin Med 2024; 1 ;13(17): 5191